



Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

UL. RACIBORSKA 26, 40-074 KATOWICE

http://www.szpital.net.pl

e-mail: szpital@szpital.net.pl

Tel. 32 2511-761

Fax. 32 2514-533

Szp. Leszcz./AT/ZLZP/RI/ 1548/15

Katowice, dnia 23.11.2015 r.

Zapytania do SIWZ

dot. przetargu nicograniczonego na zakup i dostarczanie materiałów medycznych z włókniny i flizeliny jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

Znak sprawy: Szp. Leszcz./PN/ 61 /2015.

Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zapytanie 1 – dot. Pozycji nr 3

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 3 sterylnego obłożenia uniwersalnego zgodnego z opisem zawartym w SIWZ, zawierającego w swoim składzie dodatkowo 2 ręczniki do rąk oraz 1 taśmę przyklepną 9x50cm?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie 2 – dot. Pozycji nr 4

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 4 sterylnego obłożenia uniwersalnego zgodnego z opisem zawartym w SIWZ, o nieprzemakalności 167cm H₂O?”


Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża na to zgody.

Zapytanie 3 – dot. Pozycji nr 5

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 5 niżej opisanego zestawu, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”

- 4 ręczniki do rąk
- 1 taśma przyklepna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm, składana teleskopowo
- 1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm z torebką na płyny wyposażoną w sztywne zaworki, bez zaworu drenazowego, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (owinięcie zestawu)”

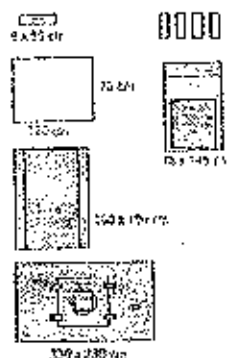


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 4 – dot. Pozycji nr 6

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 6 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 2 ręczniki do rąk
- 1 rzep 2,5 x 30 cm
- 1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm z otworem 9 x 12 cm i torebką na płyny
- 1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm z otworem 24 x 21 cm ze zintegrowanymi nogawicami (2-warstwowa na całej powierzchni)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)”

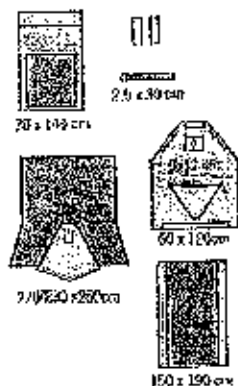**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ..

Zapytanie 5 – dot. Pozycji nr 8

„Czy Zamawiający wymaga w pozycji nr 8 zaoferowania sterylnego pokrowca foliowego na przewody z perforowaną końcówką?”

Odpowiedź:

Dopuszcza, nie wymaga..

Zapytanie 6 – dot. Pozycji nr 9

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 9 sterylnej serwety spełniającej wymogi zawarte w SIWZ, z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m²?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 7 – dot. Pozycji nr 10

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 10 sterylnego pokrowca na stolik Mayo w rozmiarze 78 x 145cm, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 8 – dot. Pozycji nr 11

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 11 fartucha ochronnego z włókniny o gramaturze 25g/m² w rozmiarze uniwersalnym 120 x 145cm?”

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 9 – dot. Pozycji nr 17

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 17 niesterylnego czepek chirurgicznego o gramaturze 14g/m², pakowanego w karton po 150szt, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?”

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Zapytanie 10 – dot. Pozycji nr 18

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie w pozycji nr 18 niesterylonego czepek chirurgicznego wykonanego z włókniny wiskozowo – poliestrowej o gramaturze 28g/m², na powierzchni górnej z włókniny polipropylenowej Spunbond o gramaturze 14g/m², spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?”

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Zapytanie 11 – dot. Pozycji nr 24

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie w pozycji nr 34 serwety operacyjnej gazowej niesterylonej 4-warstwowej z tasiemką i elementem (chipem) RTG, w rozmiarze 45 x 45cm?”

Odpowiedź:

Jeżeli dotyczy pozycji nr 24 – Nie, zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 12 – dot. SIWZ

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, bowiem z brzmienia § 1 ustęp 2 umowy, będącego częścią siwz wynika, że Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej wartości określonej w § 6 ustęp 1. Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o wyjaśnienie treści siwz w ww. zakresie. W związku z powyższym pytaniem proponujemy również następującą modyfikację postanowień umowy: ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru, pod warunkiem, że niezrealizowana ilość przedmiotu umowy nie będzie większa niż 20 % wartości tejże umowy?

Uzasadnienie: Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywać w szczególności zakres zamówienia. Innymi słowy powinien on określać „ilość zamówienia” (por. wyrok KIO z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1329/08). Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym umożliwia bowiem wykonawcom prawidłowe skalkulowanie ceny oferty, bez narażania się na ewentualne straty. Odrębną kwestią jest to, że Zamawiający tylko wskutek prawidłowego przedmiotu zamówienia będzie mógł prawidłowo oszacować wartość zamówienia z należytą starannością. Wskazać należy, że przepis art. 29 ust. 1 ustawy Pzp nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od precyzyjnego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia z podaniem jego ilości/wielkości, nawet w przypadku, gdy jego zapotrzebowanie jest trudno przewidywalne. Powyższe potwierdza stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej zaprezentowane w wyroku z dnia 24 kwietnia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 458/09, KIO/UZP 460/09), zgodnie z którym „przepis art. 29 ust. 1 ustawy nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od wyczerpującego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy zapotrzebowanie Zamawiającego jest trudno-przewidywalne. Sam fakt, że w dacie wszczęcia postępowania Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów leczniczych, nie może prowadzić do utrudnienia uczciwej konkurencji”. Stosownie do postanowienia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia opisując się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, przy czym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób wyczerpujący (art. 29 ust. 1 *in principio* ustawy Pzp), co implikuje, iż z opisu musi wynikać dokładny zakres zamówienia i warunki jego realizacji. Tym samym, Zamawiający nie może zastrzec sobie prawa arbitralnego ukształtowania zakresu zamówienia po jego udzieleniu, a postanowienia w tym zakresie należy uznać za nieskuteczne. Powyższe znajduje także potwierdzenie na gruncie judykatury. Niedopuszczalne jest zatem zastrzeżenie

przez Zamawiającego możliwości ograniczenia zakresu umowy oraz prawa wyłączenia z zakresu umowy części dostaw, gdyż takie postanowienia specyfikacji (w tym projektu umowy) prowadzą się praktycznie do przyznania sobie przez Zamawiającego nieograniczonego prawa do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji, co stanowi rażąco naruszenie przepisów ustawy Pzp, a w szczególności z art. 29 tejże ustawy (arg. z wyroku Zespołu Arbitrów z 25 stycznia 2005 r., sygn. akt. UZP/ZO/0-79/05). Ponadto, jak zauważył Sąd Okręgowy w Warszawie (orzeczenie SO dla Warszawy – Pragi z 23 listopada 2005 r., sygn. akt IV Ca 508/05), niedopuszczalne jest uzależnienie możliwości zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w części dotyczącej ilości od potrzeby Zamawiającego i odpowiednio od kontraktu zawartego z NFZ lub wskazań modycznych, gdyż jest to sformułowanie tak ogólne, że nie stanowi w istocie żadnego realnego ograniczenia. W konsekwencji, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór czy warunki przyszłej umowy powinny zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz równie precyzyjne określenie tej części zamówienia, której realizacja będzie poddana uznaniu Zamawiającego.

Wyszczególnione w ten sposób części wchodzą w zakres tego samego zamówienia, są elementem ściśle określonego zakresu przedmiotowego zamówienia o ustalonej łącznej wartości szacunkowej zamówienia, na które Zamawiający przewidział określone środki finansowe (por. art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, który określa tzw. „prawo opcji“). W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez Zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”. Izba uznała ponadto w tym przypadku, że „Zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy”.

Należy mieć przy tym na uwadze treść art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy powinien być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Podkreślenia wymaga również fakt, że również zgodnie z dominującym poglądem doktryny Zamawiający może zastrzec w umowie, że wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, o ile Zamawiający wskaże minimalny próg, do jakiego zobowiązany będzie wykonać zamówienia, a który nie będzie w sposób znaczący odbiegać od wartości maksymalnych (W. Bertman-Janik „Zamówienia na leki”, Przetargi publiczne 2007 r., nr 4, s. 40).

Mając na względzie powyższe, jak również jednolite stanowisko doktryny i judykatury w zakresie przedmiotowej kwestii, postulowana zmiana zapisu wzoru przyszłej umowy jest konieczna i w pełni uzasadniona. Wprowadzenie żądanej modyfikacji spowoduje, że opis przedmiotu zamówienia będzie jednoznaczny, wyczerpujący i Zamawiającemu nie będzie można postawić zarzutu naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy Pzp i pociągnąć go z tego tytułu do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W przypadku proponowanej zmiany zapisu umownego każdy wykonawca będzie miał możliwość prawidłowego skutkulowania wartości oferty. Na Zamawiającym będzie z kolei ciążył wynikający z umowy o zamówienie publiczne obowiązek spełnienia świadczenia co do zakresu określonego w umowie z wykonawcą jako minimalny (w tym przypadku 80 % wartości umowy) i uprawnienie do zmniejszenia zakresu zamawianych dostaw maksymalnie o 20% wartości umowy w zakresie objętym opcją.

Odpowiedź:

Zamawiający jako rzetelny uczestnik obrotu oszacował z należytą starannością wielkość na podstawie dotychczasowego zużycia, gdzie ilości faktycznie zestawione są związane z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi.

Zapytanie 13 – dot. §8 ust. 1 Istotnych Postanowień Umowy

„Czy Zamawiający w § 8 ustęp 1 zastąpi słowa „wartości niezrealizowanego zamówienia” słowami „wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie”?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 14 – dot. Pozycji nr 14

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pozycji 14** fartuchów chirurgicznych barierowych wykonanych w polu krytycznym z tkaniny o gramaturze 85 g/m², natomiast w polu niekrytycznym wykonany z tkaniny o gramaturze 70 g/m²? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Uzasadnienie: Gramatura tkaniny nie ma wpływu na jej barierowość. Tkanina o niższej gramaturze może tak samo spełniać wymagania normy. Gramatura ma natomiast zasadniczy wpływ na komfort użytkowników oraz koszty prania. Większa gramatura to większy ciężar fartucha oraz mniejsza przepuszczalność powietrza. Im dłuższy zabieg tym bardziej jest to uciążliwe dla personelu. Większa waga tkaniny podwyższa też koszty jej prania.”

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 15 – dot. Pozycji nr 18

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pozycji nr 18 czepka z chłonnej włókniny wiskozowej bez dodatkowego potnika?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 16 – dot. Pozycji nr 20

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pozycji nr 20 serwetę z włókniny SMS? Nazwa TMS dotyczy włókniny SMS stosowanej przez jedną z firm.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 17 – dot. Pozycji nr 21

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pozycji nr 21 pościeli z włókniny SMS? Nazwa TMS dotyczy włókniny SMS stosowanej przez jedną z firm.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 18 – dot. Pozycji nr 21

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pozycji nr 21 pościeli z poszwą o wymiarowaniu 160x200cm?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 19 – dot. Pozycji nr 3- 7; 9; 33

„**Poz. nr 3- 7; 9; 33** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet i zestawów wykonanych z 2- warstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m²?”

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Zapytanie 20 – dot. Pozycji nr 2-4; 6-7; 9-10; 12; 26-28

„**Poz. nr 2-4; 6-7; 9-10; 12; 26-28-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania produktów pakowanych w opakowania posiadające jedną 2- dzielną etykietę samoprzylepną, przy czym jedna z części w postaci kodu kreskowego (etykieta zawiera m.in. datę ważności i nr serii)?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 21 – dot. Pozycji nr 32

„**Poz. nr 32-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania produktów pakowanych w opakowania posiadające jedną etykietę samoprzylepną?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 22 – dot. Pozycji nr 3

„Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe

Pozostałe parametry bez zmian.”

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Zapytanie 23 – dot. Pozycji nr 4

„Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z laminatu 2- warstwowego z dodatkowymi padami chłonnymi, o nieprzemakalności min. 150 cm H₂O o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe

Pozostałe parametry bez zmian.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 24 – dot. Pozycji nr 5

„Poz. nr 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)
- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypchnionym folią chirurgiczną 250x315 cm (ulożenie płasko na stole)
- 1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 2 ręczniki celulozowe

Opakowanie posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci 4 naklejek.”

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Zapytanie 25 – dot. Pozycji nr 6

„Poz. nr 6- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów ginekologicznych o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów i otworem (9 x 12 cm) 290 x 250 cm
- 1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 1 ręcznik celulozowy

Dodatkowo pakowana niezależnie od zestawu serweta na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 145 cm.”

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 26 – dot. Pozycji nr 7

„Poz. nr 7- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii ginekologicznej o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 serweta operacyjna nieprzylepna 75 x 90 cm
- 1 serweta do chirurgii odbytnicy z padem chłonnym (okno 28 x 32 cm i 15 x 12 cm) 300 x 250 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 2 uchwyty Velero 2 x 23 cm
- 4 ręczniki celulozowe.”

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 27 – dot. Pozycji nr 10

„Poz. nr 10- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowca na stolik Mayo w kolorze zielonym? Pozostałe parametry bez zmian.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 28 – dot. Pozycji nr 11

„Poz. nr 11- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha ochronnego w rozmiarze uniwersalnym, o gramaturze 28 g/m², posiadającego rękawy zakończone lekko uciskającą gumką (nie zawierającą lateksu)?”

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 29 – dot. Pozycji nr 12, 28

„Poz. nr 12; 28- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów zapinanych przy szyi na taśmę samoprzylepną, która pozwala na precyzyjne dopasowanie fartucha do rozmiaru ciała na wysokości barków? Pozostałe parametry bez zmian.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 30 – dot. Pozycji nr 16

„Poz. nr 16- czy w pozycji tej nie doszło do omyłki dotyczącej dodatkowych wymagań w przypadku masek chirurgicznych? Pytanie nasze wynika z faktu, iż Zamawiający wymaga, aby maski spełniały normę PN-EN 13795, która nie obejmuje powyższego asortymentu.”

Odpowiedź:

Tak, omyłka.

Zapytanie 31 – dot. Pozycji nr 17

„Poz. nr 17- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka chirurgicznego o gramaturze 14 g/m²? Pozostałe parametry bez zmian.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 32 – dot. Pozycji nr 18

„Poz. nr 18- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka chirurgicznego posiadającego wydłużoną część tylną ze ściągaczem, wykonanego na całej powierzchni z włókniiny pochłaniającej pot? Pozostałe parametry bez zmian.”

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Zapytanie 33 – dot. Pozycji nr 26

„Poz. nr 26- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu 2-warstwowego (polipropylen- polietylen)? Pozostałe parametry bez zmian.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 34 – dot. Pozycji nr 32

„Poz. nr 32- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

Skład zestawu: *

1. 6 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm
2. 4 x tampony z gazy bawełnianej wielkości sławki (Fagaling Nr 3)
3. 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm
4. 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm
5. 1 x serweta włókninowa, nieprzyklepna 45 cm x 75 cm
6. 1 x serweta włókninowa, 45 cm x 75 cm z regulacją otworu (serweta składa się z 2 oddzielnych części, otwór przyklepny)
7. 1 x strzykawka Luer 10 ml, (zapakowana)
8. 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18G x 1^{1/2}, różowa (zapakowana)
9. 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21G x 1^{1/2}, zielona (zapakowana)
10. 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane)
11. 1 x igłobuzymacz typu Derf 13 cm
12. 1 x opatrunek transparentny z folii polietanowej Hydrofilm: 10 cm x 15 cm, (zapakowany)

Opakowanie

Tacka typu blister z 2 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Zapytanie 35 – dot. Pozycji nr 33

„Poz. nr 33- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

- 1 x serweta 2- warstwowa (gram 55 g/m²) na stół narzędziowy 75 x 75 cm (opakowanie zestawu)
- 2 x serweta 3- warstwowa (gram 74 g/m²) 60 x 50 cm, otwór przyklepny Ø 7 cm centralnie
- 1 x igła iniekccyjna 18G, 1,20 x 50 mm
- 1 x igła iniekccyjna 21G, 0,80 x 50 mm
- 1 x strzykawka 10 ml Luer, 2 części, biała, decentralna
- 2 x strzykawka 20 ml Luer, 2 części, biała, decentralna
- 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm, zielona
- 6 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm 8 warstw 17 nitok
- 2 x opatrunek na ranę 7,2 x 5 cm

Opakowanie posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci 4 naklejek.

LUB

- 1 x serweta 2- warstwowa (gram 55 g/m²) na stół narzędziowy 75 x 45 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta 3- warstwowa (gram 74 g/m²) epiduralna przyklepna 60 x 75 cm, otwór przyklepny romb 10 x 10 cm decentralnie
- 1 x igła iniekccyjna 25 G, 0,50 x 38 mm
- 1 x igła iniekccyjna 18 G, 1,20 x 38 mm
- 1 x strzykawka 2 ml Luer, 2 części, biała, centralna
- 1 x strzykawka 5 ml Luer, 2 części, biała, decentralna
- 1 x opatrunek na ranę operacyjną 7,2 x 5 cm
- 1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 19 cm, niebieskie
- 3 x kompres z włókniny 10 x 10 cm, 6 warstw, 30g/m²
- 6 x tuffer z gazy No. 4 24 x 24 cm, 20 nitok
- 1 x pojemnik plastikowy 120 ml (9,2 x 3 cm), z podziałką, przezroczysty niebieski

Opakowanie posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci 4 naklejek”

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 36 – dot. dot. §3 ust. C Istotnych Postanowień Umowy

„§ 3, ust. C- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących niezmienności cen na następującą:

„Wykonawca gwarantuje przez cały okres obowiązywania umowy niezmiennosc ceny brutto, z wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT, gdzie zmianie ulegnie cena brutto i podatek, cena netto pozostanie bez zmian”.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 37 – dot. dot. §8 ust. 2 Istotnych Postanowień Umowy

„§ 8, ust. 2- wnosimy o odstąpienie od zapisów wymienionego paragrafu. Zamawiający w § 2, ust. 3 jasno określił, iż towar ma zostać dostarczony „loco” (bezpośrednio) magazyn szpitala. Wobec tego naliczanie kar umownych w tym przypadku wydaje się bezpodstawne.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 38 – dot. Pozycji nr 2

„Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 50 cm x 70 cm?

Opakowanie posiada 4 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi normy EN-PN 13795”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 39 – dot. Pozycji nr 3

„Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włókna + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włókna + laminat) w części środkowej serwety. Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m². Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmocniającej 140 cm x 60 cm. Chłonność serwety 350%.

1 x Serweta o wym. 150 cm x 180 cm

Serweta dwuwarstwowa (włókna + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%. Serweta z przylepcem.

1 x Serweta o wym. 150 cm x 240 cm

Serweta dwuwarstwowa (włókna + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%. Serweta z przylepcem.

2 x Serweta o wym. 75 cm x 90 cm

Serweta dwuwarstwowa (włókna + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%. Serweta z przylepcem.

2 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²

1 x Taśma przylepna o wym. 10 cm x 50 cm?

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m², chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw jałowy, sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC. Opakowanie posiada 4 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.”

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Zapytanie 40 – dot. Pozycji nr 4

„Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cmSerweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyiny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.**1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm**

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyiny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m². Serweta składana teleskopowo,

z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.

Chłonność serwety 350%.

1 x Serweta o wym. 170 cm x 180 cmSerweta trójwarstwowa, w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m². W polu

krytycznym łata chłonna/wzmocnienie z włókniny i laminatu o wym. 50 cm x 80 cm. Gramatura serwety

w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na

rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta z przylepcem, posiada pojedynczy organizer na 4 przewody.

1 x Serweta o wym. 170 cm x 240 cmSerweta trójwarstwowa, w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m². W polu

krytycznym łata chłonna/wzmocnienie z włókniny i laminatu o wym. 30 cm x 80 cm. Gramatura serwety

w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na

rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta z przylepcem, posiada pojedynczy organizer na 4 przewody.

2 x Serweta o wym. 75 cm x 90 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyiny, warstwa

lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

Serweta z przylepcem.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 cm x 50 cm**4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm**Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m², chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw jałowy, sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC. Opakowanie posiada 4 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.”

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Zapytanie 41 – dot. Pozycji nr 5

„Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cmSerweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyiny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.**1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm**

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyiny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m². Serweta składana teleskopowo,

z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.

Chłonność serwety 350%.

1x serweta o wym. 200 x 320cm

Serweta z włókniny typu SMS, gramatura 51g/2, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm, z torbą na płyny o wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20 cm., usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki, z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach dolnej części worka, budowa końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

1x serweta chłonna dla noworodka o wym. 75 cm x 80 cm

Serweta z włókniny spunlace o gramaturze 75g/m²

1x taśma przyklepna o wym. 10 x 50cm**4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm**

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m², chłonności 180%, stanowiącą pierwsz, zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw jałowy, sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC. Opakowanie posiada 4 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795."

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Zapytanie 42 – dot. Pozycji nr 7

„Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwową (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwową (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m². Serweta składana teleskopowo,

z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwi wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.

Chłonność serwety 350%.

1 x Serweta laparoskopowa o wym. 200 cm x 260 cm

Serweta z włókniny, typu SMS, gramatura 51 g/m², z folią chirurgiczną, otwór. 30 x 30cm, serweta w kształcie litery T

2 x Nogawica, 70 cm x 120 cm

Wykonana z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m², z podwójnie wywiniętym brzegiem

1 x Taśma przyklepna o wym. 10 cm x 50 cm**1 x Pokrowiec na przewody o wym. 14 cm x 250 cm**

Ostona na przewody z przezroczystej folii polietylenowej, złożona teleskopowo. Na jednym końcu posiada kartonowy sztywnik z oznaczeniem kierunku rozwijania ostony, na drugim końcu perforację umożliwiającą wysunięcie przewodu.

Na obu końcach ostony po jednym przyklepcu o wym. 17cm x 2,5 cm umożliwiającym fiksację folii.

4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m², chłonności 180%, stanowiącą pierwsz, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw jałowy, sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC. Opakowanie posiada 4 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795."

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 43 – dot. Pozycji nr 9

„Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 56g/m², wytrzymałość na wypychanie - na sucho 108 kPa Wytrzymałość na wypychanie - na mokro 95 kPa?

Opakowanie posiada 4 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi normy EN-PN 13795.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 44 – dot. Pozycji nr 10

„Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo wzmocnioną, czerwoną. Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety. Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety 80g/m². Boki i część dolna serwety jednowarstwowe z PE o gramaturze 50g/m². Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwi wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmocniającej 140 cm x 60 cm.

Chłonność serwety 350%.

Serweta jałowa, sterylizowana radiacyjnie. Opakowanie papier - folia. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Opakowanie posiada 4 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi normy EN-PN 13795”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 45 – dot. Pozycji nr 11

„Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 30g/m²?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 46 – dot. Pozycji nr 12

„Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMS.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 47 – dot. Pozycji nr 13

„Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy o wym. 71x116cm oraz 71 x 130cm o grubości 0,02mm?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 48 – dot. Pozycji nr 18

„Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany w całości z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m²?”

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 49 – dot. Pozycji nr 18

„Czy Zamawiający dopuści czepek o właściwościach:

- Czepek głęboki typu „furażerka” z trokami
- Wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m²



- Zapewnia doskonałą oddychalność i komfort użytkowania
- Po wywinieciu część przednia utworzy dodatkową warstwę stanowiącą zabezpieczenie przed potem
- Kolor: zielony, niebieski
- Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający pojedyncze wyjmowanie
- Niejałowy”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 50 – dot. Pozycji nr 18

„Czy Zamawiający dopuści czepek o właściwościach:

- Czepek wkładany typu „furażerka”, bez gumki oraz troków.
- Posiada dwie warstwy włókniny w części bocznej
- Wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m²
- Zapewnia doskonałą oddychalność i komfort użytkowania
- Kolor: zielony, niebieski
- Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik
- Niejałowy”



Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 51 – dot. Pozycji nr 20

„Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny SMS, pozostałe wymagania zgodnie z siwz?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 52 – dot. Pozycji nr 20

„Czy Zamawiający dopuści prześcieradło ze zwyczajnej włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m², pozostałe wymagania zgodnie z siwz?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 53 – dot. Pozycji nr 21

„Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli ze zwyczajnej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m² z prześcieradłem o wymiarach 210x150cm, pozostałe składowe zgodne z siwz?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 54 – dot. Pozycji nr 22

„Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniny polipropylenowej i folii na stronie tylnej, pozostałe wymagania zgodnie z siwz?”

Opakowanie posiada 4 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi normy EN-PN 13795”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 55 – dot. Pozycji nr 25

„Czy Zamawiający dopuści scrwetę pakowaną; a2 szt?”

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie 56 – dot. Pozycji nr 25

„Czy Zamawiający odstąpi od wymogu opakowania zawierającego naklejki do umieszczenia do dokumentacji, informacje o dacie ważności i serii zawiera standardowe opakowanie?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 57 – dot. Pozycji nr 26

„Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z włókniny polipropylenowej i folii na stronie tylnej z otworem o średnicy 6cm, pozostałe wymagania zgodnie z siwz?”

Opakowanie posiada 4 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi normy EN-PN 13795.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 58 – dot. Pozycji nr 27

„Czy Zamawiający dopuści serwetę, której opakowanie posiada 4 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi normy EN-PN 13795.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 59 – dot. Pozycji nr 28

„Czy Zamawiający dopuści fartuch ze wzmocnieniami o gramaturze 387g/m², którego opakowanie posiada 4 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi normy EN-PN 13795, pozostałe wymagania zgodnie z siwz?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 60 – dot. Pozycji nr 29

„Czy Zamawiający dopuści czepek o wyglądzie i właściwościach:

- Czepek z wstawką antypotną w części czołowej
- Dzięki specjalnej konstrukcji świetnie podtrzymuje włosy oraz dopasowuje się do kształtu głowy
- Stanowi doskonałe zabezpieczenie dla osób z dłuższymi włosami
- Wykonany z włókniny Spunlace oraz włókniny polipropylenowej
- Doskonała oddychalność i komfort użytkowania
- Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający pojedyncze wyjmowanie pojedynczych sztuk
- Jednorazowego użytku
- Nicjałowy”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 61 – dot. Pozycji nr 30

„Czy Zamawiający odstąpi od wymogu opakowania zawierającego naklejki do umieszczenia do dokumentacji, informacje o dacie ważności i serii zawiera standardowe opakowanie?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 62 – dot. Pozycji nr 34

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, plynny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, plynny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m². Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmocniającej 140 cm x 60 cm. Chłonność serwety 350%.

1 x Serweta do cesarskiego cięcia o wym. 200 cm x 320 cm

Serweta typu SMS, gramatura 51g/2, z otworem z folią operacyjną o wym. 25 cm x 30 cm, torbą do zbiórki płynów o wym. 75 cm x 85 cm ze sztywnikiem, filtrem, 2 - ma końcówkami do podłączenia ssaka

1 x Serweta chłonna dla noworodka o wym. 75 cm x 80 cm

Serweta z włókniny spunlace o gramaturze 75g/m²

10 x Serweta operacyjna z gazy z nitką RTG i tasiemką o wym. 45 cm x 45 cm

20 x Tupfer gazowy o wym. 30 cm x 30 cm

1 x Taśma przyklepna o wym. 10 cm x 50 cm

1 x Przylepice Velcro o wym. 2 cm x 22 cm

4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²

1 x Fartuch chirurgiczny Standard rozm. L

3 x Fartuch chirurgiczny Standard rozm. XL

Fartuch Standard - jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny. Gramatura 45g/m².

Wykonany z włókniny SSMMS.

Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylnie części fartucha zachodzą na siebie.

Posiada 4 wszywane troki o długości 45 cm, umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 - 7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez wszytą metkę w okolicy karku, od strony wewnętrznej fartucha. Odporność na przesiekanie płynów 40,5 cm H₂O, odporność na przenikanie mikroorganizmów na mokro: IB 3,58.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m², chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw jałowy, sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC. Opakowanie posiada 4 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795."

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 63 – dot. SIWZ

„Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie pozycji 14 Zamawiający uzna jako wykaz wykonanych 2 głównych dostaw którego przedmiotem będzie jest dostawa fartuchów barierowych wielorazowego użytku o wartości nie mniejszej niż ¼ wartości brutto podanej w formularzu ofertowy dla tej pozycji?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ - Wykonawca musi wykazać się co najmniej 2 dostawami odpowiadającymi swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia.

Zapytanie 64 – dot. Pozycji nr 14

„Zamawiający w pozycji nr 14 złożył zamówienie na fartuch chirurgiczny barierowy wielokrotnego użytku, zgodny z normą PN-EN 13795, wykonany z poliestru 98-99% +1-2% włókno węglowe (antyelektrostatyczne), gramatura pola krytycznego ok. 122-135g/m², - gramatura pola niekrytycznego ok. 74-125 g/m², z tkaniny oddychającej. Fartuch skonstruowany w ten sposób jest niekomfortowy. Najlepszym rozwiązaniem dla fartuchów operacyjnych wielorazowych jest stosowanie tkanin poliestrowych w polu krytycznym oraz tkanin bawełniano - poliestrowych w polu niekrytycznym. Tylko

taka konstrukcja zapewnia maksimum bezpieczeństwa i komfortu. W ofercie posiadamy fartuchy operacyjne wykonane:

- w polu krytycznym z tkaniny poliestrowej 99% poliestru 1% włókna węglowego o gramaturze 100 g/m² o odporności na przenikanie cieczy powyżej 90 cm H₂O, w pełni zgodnej z normą PN-EN 13795,
- w polu niekrytycznym natomiast z tkaniny bawełniano - poliestrowej 55% bawełny 45% poliestru o gramaturze 118 g/m² o przepuszczalności powietrza powyżej 55 cm³/cm²*s, zgodnej z normą w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych oraz parametrów wytrzymałościowych.

Taka konstrukcja fartuchów operacyjnych jest najbardziej komfortowa, ale też bezpieczna z punktu widzenia operatorów. Wysoka odporność pola krytycznego na przenikanie cieczy na poziomie powyżej 90 cm H₂O zapewnia duży poziom bezpieczeństwa, gwarantujący barierowość przez 100 cykli PSS. Natomiast lekka waga i doskonałe właściwości „oddychania” w polu niekrytycznym sprawiają, że komfort pracy jest bardzo duży.

Czy Zamawiający, dbając o bezpieczeństwo i komfort użytkownika wymaga w Pozycji 14 fartuchów operacyjnych o konstrukcji jak poniżej:

- strefa krytyczna z tkaniny poliestrowej o gramaturze max. 100 g/m² o odporności na przenikanie cieczy co najmniej 90 cm H₂O, w pełni zgodnej z normą PN-EN 13795,
- strefa niekrytyczna z chłonnej tkaniny bawełniano - poliestrowej o zawartości bawełny min. 55%, o gramaturze max. 120 g/m², o przepuszczalności powietrza co najmniej 55 cm³/cm²*s, zgodnej z normą w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych oraz parametrów wytrzymałościowych?

Taka konstrukcja fartucha zapewnia bardzo duży poziom bezpieczeństwa oraz maksymalnie możliwy komfort pracy. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.”

Odpowiedź:

Dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie 65 – dot. SIWZ

„Zwracamy się z zapytaniem czy na potwierdzenie wymaganych parametrów w postaci arkusza danych technicznych materiału podstawowego - włókniny - potwierdzający zgodność z normą PN-EN 13795 1,2,3 uzna za spełniony arkusz danych technicznych produktu gotowego - potwierdzający zgodność z normą PN-EN 13795 1,2,3?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 66 – dot. Pozycji nr 3

„Zwracamy się z zapytaniem czy w pozycji nr 3 dopuści sterylne obłożenie uniwersalne w następującym składzie:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm
 - 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm
 - 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 170x175cm
 - 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm
 - 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
 - 4 ręczniki 30x40cm
- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x190 cm, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?”

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Zapytanie 67 – dot. Pozycji nr 5

„Zwracamy się z zapytaniem czy w pozycji nr 5 dopuści zestaw sterylny do cięcia cesarskiego posiadając serwetę główną w kształcie litery T o min. wym. 250x315cm, z przyklepnym oknem o min. wym. 18x28x32cm z pełną folią chirurgiczną otoczonym torbą do zbiórki płynów z 2. zaworkami spustowymi, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?”

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Zapytanie 68 – dot. Pozycji nr 1

„Czy Zamawiający dopuści fartuch wiązany na troki w pasie i z tyłu na wysokości szyi w uniwersalnych rozmiarach I. i XL przy zachowaniu pozostałych wymagań?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 69 – dot. Pozycji nr 2

„Czy Zamawiający dopuści zaoficerowanie serwetki bez dwóch etykiet odlepných przy zachowaniu pozostałych wymagań?”

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Zapytanie 70 – dot. Pozycji nr 3

„Czy Zamawiający dopuści obłożenie uniwersalne z owinięciem zestawu w wymiarze 140x190 cm oraz z dodatkowymi 4 ręczniczkami i taśmą samoprzylepną w rozmiarze 9x49 cm, nieprzemakalności serwet min. 100 cm H₂O oraz rozterwaniu na sucho/mokro 88/61 kPa przy zachowaniu pozostałych wymagań?”

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Zapytanie 71 – dot. Pozycji nr 6

„Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów ginekologicznych w następującym składzie :

1. serweta chirurgiczna do zabiegów ginekologicznych dolnych o wymiarach 240/150x150 cm zintegrowana z nogawicami, posiada otwór samoprzylepny o wymiarach 10x15 cm w okolicach kroczka	240/150x150	1
2. taśma samoprzylepna do przechwytywania płynów ze szływnikiem	60x60	1
3. taśma samoprzylepna	9x49	1
4. ręczniki chłonne	30x40	2
5. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze szływnikiem	2x15x40	1
6. osłona na stolik MAYO	79x145	1
7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x200	1

Lub :

1. serweta chirurgiczna do zabiegów ginekologicznych dolnych o wymiarach 240/150x150 cm zintegrowana z nogawicami, posiada otwór samoprzylepny o wymiarach 10x15 cm w okolicach kroczka, oraz zintegrowaną kieszeń na płyny o wymiarach 30x30 cm wyposażoną w szływnik	240/150x150	1
2. serweta chirurgiczna	75x90	1
3. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x200	1

przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ bez zmian?”

Odpowiedź:

Nie dopuszcza.

Zapytanie 72 – dot. Pozycji nr 8

„Czy Zamawiający dopuści pokrowiec foliowy na przewody o wymiarze 17x200 cm przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ bez zmian?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 73 – dot. Pozycji nr 10

„Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo o wymiarze 79x145 cm przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ bez zmian?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 74 – dot. Pozycji nr 11

„Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny PP o gramaturze min. 28 g/m² przy zachowaniu przy pozostałych parametrów?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 75 – dot. Pozycji nr 12

„Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny w rozmiarach L, XL, XXL=XXXL przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ bez zmian?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 76 – dot. Pozycji nr 13

„Czy Zamawiający dopuści fartuch przedni w rozmiarach 75 x 155 cm i 75 x 145 cm przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ bez zmian?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 77 – dot. Pozycji nr 27

„Czy Zamawiający serwetę z otworem o wymiarze 6x8 cm przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ bez zmian?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 78 – dot. Pozycji nr 34

„1. Czy Zamawiający dopuści serwetę do Ciecicia Cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną o wymiarze 38cm x32 cm?

2. Czy Zamawiający dopuści próbkę w wersji niesterylnej?

2. Czy Zamawiający wymaga ctykiety produktu opatrzonej polskim opisem przeznaczenia i składu zestawu?”

Odpowiedź:

Ad. 1. – Tak.

Ad. 2. – Tak.

Ad. 3. – Tak.

Zapytanie 79 – dot. Istotnych Postanowień Umowy

„Czy Zamawiający zgodzi się dodać do umowy zapis dotyczący zmiany cen brutto w wyniku ustawowej zmiany stawki VAT przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ bez zmian?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 80 – dot. Pozycji nr 3

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia uniwersalnego spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego, które zawiera dodatkowo 2 ręczniki chłonne o wym. 30x40cm?”

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Zapytanie 81 – dot. Pozycji nr 4

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia uniwersalnego wykonanego z 3-warstwowego laminatu o gramaturze 74,5 g/m² o wytrzymałości na wypychanie na mokro 224kPa, nieprzemakalności 150 cm H₂O? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Zapytanie 82 – dot. Pozycji nr 4

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia uniwersalnego wykonanego z chłonnego, nieprzemakalnego 3-warstwowego laminatu o gram. 112,5 g/m² wokół pola operacyjnego

o wytrzymałości na wypychanie na mokro 270 kPa, nieprzemakalności > 125 cm H₂O, pozostały obszar obłożenia wykonany z materiału 2-warstwowego o gramaturze 57,5 g/m² o wytrzymałości na wypychanie na mokro 274 kPa, nieprzemakalności 125 cm H₂O? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 83 – dot. Pozycji nr 5

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do cięcia cesarskiego zawierającego serwetę o rozmiarze 335 x 260/200 cm z otworem prostokątnym 27 x 33 cm z oknem otoczonym folią chirurgiczną 14 x 20 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Zapytanie 84 – dot. Pozycji nr 5

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do cięcia cesarskiego wykonanego z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 48 g/m² w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm

2 ręczniki 30 x 20 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 x 90 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego 230/200 x 312 cm z otworem w obszarze jamy brzusznej, ze zintegrowaną folią chirurgiczną, torbą na płyny, w tym z zaworem do podłączenia drenu, z osłoną podpórek kończyn górnych. Obłożenie pakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Opakowanie posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej.”

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 85 – dot. Pozycji nr 6

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do zabiegów ginekologicznych dolnych wykonanego z chłonnego, mocnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gram. 57,5 g/m², wzmocnionego dodatkową trzecią warstwą laminatu wokół pola operacyjnego o łącznej gramaturze 112,5g/m² spełniającego wymogi normy EN 13795 (1-3) składającego się z serwetki o wym. 230 x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, posiadającą otwór na krocze 10 x 15cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem, 1 serwetą na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, 2 ręcznikami 30 x 40 cm, 1 serwetą na stolik Mayo 80 x 145 cm, taśmą lepą 9x50cm i serwetą samoprzylepną 50x50cm? Obłożenie pakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Opakowanie posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej.”

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Zapytanie 86 – dot. Pozycji nr 7

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do laparoskopii ginekologicznej, obecnie używanego w szpitalu, wykonanego z chłonnego, mocnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57,5 g/m², posiadająca dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej o 112,5 g/m² (gramatura podstawowa plus wzmocnienie). Obłożenie spełnia wymogi normy EN 13795 (1-3), posiada serwetę główną o wymiarach 260 cm x 310 cm, wyposażoną w zintegrowane osłony na kończyny dolne, organizatory przewodów, samoprzylepny otwór w okolicy jamy brzusznej o wymiarach 28 cm x 32 cm oraz samoprzylepny otwór w okolicach krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczony kłapką. Zestaw posiada serwetę na stolik Mayo 80x145 cm, 4 ręczniki 30 x 40 cm oraz serwetę na stolik (owinięcie zestawu) o wymiarze 150 x 190 cm. Obłożenie pakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Opakowanie posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej.”

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Zapytanie 87 – dot. Pozycji nr 9

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania serwety wykonanej z dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 57,5 g/m²? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego?”

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Zapytanie 88 – dot. Pozycji nr 11

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania fartucha ochronnego z włókniny, z mankietem, w rozmiarze uniwersalnym o gram. 21g/m²?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 89 – dot. Pozycji nr 24

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania serwety operacyjnej o rozmiarze 55 x 65 cm? Pozostałe parametry serwety zgodne z wymaganiami Zamawiającego?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 90 – dot. Pozycji nr 26

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania serwety operacyjnej z otworem o średnicy 6 cm? Pozostałe parametry serwety zgodne z wymaganiami Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 91 – dot. Pozycji nr 9

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji serwety wykonanej z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 60 g/m², pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystniejsze dla Zamawiającego pod względem ilościowym i jakościowym.”

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Zapytanie 92 – dot. Pozycji nr 11

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji fartucha ochronnego o gramaturze min. 25g/m². Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystniejsze dla Zamawiającego pod względem ilościowym i jakościowym.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 93 – dot. Pozycji nr 17

„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w w/w pozycji oczekuje czepka chirurgicznego typu beret czy czepka chirurgicznego typu furażerka.”

Odpowiedź:

Typu beret.

Zapytanie 94 – dot. Pozycji nr 17

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji czepka o gramaturze minimum 14g/m². Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystniejsze dla Zamawiającego pod względem ilościowym i jakościowym.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 95 – dot. Pozycji nr 19

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji ochraniaczy na obuwiu o gramaturze minimum 17g/m². Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystniejsze dla Zamawiającego pod względem ilościowym i jakościowym.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 96 – dot. Istotnych Postanowień Umowy

„W związku z postępowaniem przetargowym ogłoszonym przez Państwa jednostkę oraz brakiem zamieszczenia w projekcie umowy stanowiącym załącznik NR 4 do SIWZ postanowienia, przewidującego zmianę (wzrost) ceny w przypadku zmiany (wzrostu) wysokości stawek podatku VAT, wnosi o uzupełnienie treści projektu umowy o wskazany poniżej zapis umowny:

Zamawiający zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy cenę netto powiększoną o należny podatek VAT w kwocie obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wystawienia faktury VAT.

Stanowisko to motywowane jest następującymi względami.

Podatek VAT stanowi element cenotwórczy niezależny od woli Wykonawcy. Wliczona do ceny oferty kwota podatku VAT jako daniny publicznoprawnej, do odprowadzenia której zobowiązany jest Wykonawca, nie ma przy tym wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez Wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

W ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny brutto wyliczonej zgodnie ze stawkami podatku VAT obowiązującymi w dacie sporządzania oferty. Obliczenie ceny w oparciu o nieprawidłową (w tym także przyszłą, przewidywaną, lecz jeszcze nie obowiązującą) stawkę podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny skutkujący odrzuceniem oferty na zasadzie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

Wzrost stawek podatku VAT jest okolicznością zewnętrzną, na którą Wykonawcy nie mają żadnego wpływu. Wzrost taki, do którego dojść może w okresie trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego (przewidywana zmiana stawek podatku VAT na wyroby medyczne z 8 do 23%), przy obowiązku zachowania niezmiennej ceny brutto, spowoduje nie tylko zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia ceny oferty, lecz nawet skutkować może rażąco strata po stronie Wykonawcy. Cenę ofertową Wykonawcy kalkulują bowiem według aktualnej stawki podatku VAT oraz – z uwagi na dużą konkurencję – przy przyjęciu minimalnej marży. W tym warunkach zwiększenie stawki podatku VAT o 15% powoduje, iż pierwotna kalkulacja ceny traci na aktualności, zaś umowa w sprawie zamówienia publicznego przynosi Wykonawcy straty.

W piśmiennictwie nie budzi wątpliwości dopuszczalność zawarcia w umowach dotyczących zamówień publicznych indeksacji wynagrodzenia bądź ceny stosownie do spodziewanej okoliczności w trakcie realizacji umowy (np. zmiany stawki podatku VAT). Chodzi tu bowiem o samoczynną korektę wynagrodzenia, na podstawie pierwotnej woli stron wyrażonej w umowie, a nie o nowelizację umowy co do zasady niedopuszczalną na mocy art. 144 p.z.p.

W związku z powyższym prawnie możliwym, a nade wszystko uzasadnionym jest, aby w ramach zasad obowiązujących w uczciwym obrocie handlowym, wprowadzili Państwo do projektu umowy stosowną klauzulę przewidującą zmianę ceny w związku ze zmianą stawki podatku VAT.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 97 – dot. Pozycji nr 1

„Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wiązany i zapinany na rzep przy szyi i troki w pasie? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.”

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Zapytanie 98 – dot. Pozycji nr 2

„Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z laminatu z włókniny polipropylonowej i folii polietylenowo-polipropylonowej? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.”

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Zapytanie 99 – dot. Pozycji nr 3

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Element składowy	Ilość	Symbol	Wymiary (cm)
serweta z przylepcem	1	L2	240x150
serweta z przylepcem	1	L2	180x170
serweta z przylepcem - przyłolec na szerszym boku	2	L2	90x75
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20

Reszta parametrów zgodna z SIWZ."

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Zapytanie 100 – dot. Pozycji nr 5

„Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym serweta główna posiada otwór w kształcie prostokąta o wymiarze 32x35cm oraz dodatkowo zestaw posiada serwetki do rąk 2szt. oraz 1szt. podkładu chłonnego z pulpy celulozowej? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.”

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Zapytanie 101 – dot. Pozycji nr 7

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Element składowy	Ilość	Symbol	Wymiary (cm)
serweta z zintegrowanymi nogawicami oraz ekranem anestezyjnym; w górnej części otwór na brzuch 30x34cm wypełniony folia chirurg., w części dolnej otwór 15x10cm z klapką 30x20cm, taśma przylepna w części brzusznej	1	L3	260x240
serweta przeznaczona pod pościadki	1	L2	90x75
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
kieszona na płynie	1	PE - 2K	42x35
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	4	włók. kom.	40x20

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 102 – dot. Pozycji nr 8

„Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec foliowy na przewody o rozmiarze 13x244 cm zakończony z jednej strony usztywniającym kartonikiem ułatwiającym zakładanie pokrowca z wycięciem na przewód oraz taśmą mocującą na przeciwnym końcu?”

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 103 – dot. Pozycji nr 9

„Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z laminatu o gramaturze 56g/m²?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 104 – dot. Pozycji nr 10

„Czy Zamawiający dopuści pokrowiec wykonany z folii PE o grubości 0,045 mm, o poziomie nieprzemakalności min. 30 H₂O oraz wytrzymałości na rozciąganie min. 40 Kpa?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 105 – dot. Pozycji nr 14

„Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny barierowy wykonany z tkaniny poliestrowej o składzie 99,3% + 0,7% włókna węglowego oraz gramatury tkaniny na poziomie 84g/m² w obrębie pola mniej krytycznego i pola krytycznego? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 106 – dot. Pozycji nr 21

„Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie:

Skład	
powłoka	200 x 150cm
powłoczka	90 x 75cm
prześcieradło	210 x 150cm

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 107 – dot. Pozycji nr 26

„Czy Zamawiający serwetę bez przylepca?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 108 – dot. Pozycji nr 30

„Czy Zamawiający dopuści folię pakowaną pojedynczo w opakowanie papier-papier nie posiadające naklejek? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 109 – dot. Pozycji nr 32

„Czy Zamawiający wymaga zestawu zapakowanego w sztywne przezroczyste opakowanie, które ma służyć jednocześnie jako pojemnik?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 110 – dot. Pozycji nr 33

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Opis	Wymiary / Objętość	Ilość
serweta FB	75x45cm	1
serweta 1,2 50x60cm z otworem 10cm	50x60cm, Ø10cm	1
strzykawka 3ml	3ml	1

strzykawka 5ml	5ml	1
igła 1,2x40mm	1,2x40mm	1
igła 0,5x25mm	0,5x25mm	1
kompres z włókniny 30 gram, 4W	7,5x7,5cm	10
Opatrunek Fixopore S	5x7,2cm	1
penseta plastikowa	13 cm	1

Całość zapakowana w blister.

Rozsługa parametrów zgodna z SIWZ.”

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 111 – dot. Pozycji nr 34

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- serweta 320x180 cm z otworem prostokątnym 32x35cm, wypełniony folią chirurgiczną, serweta posiada okalający zintegrowany worek do przychwytywania płynów wyposażony w sztywnik i 2 zawory drenażowe – 1 szt.,
- pokrowiec na stół Mayo 80x145cm,
- serweta na stół instrumentarium (owinięcie zestawu) o wym. 150x190cm.
- fartuch chirurgiczny – 3 szt., w rozm. L 2 szt., w rozm. XL - 1 szt., z włókniny typu SMS o gram. min. 35g/m²,
- kompres gazowy – 80 szt. (4x20 szt.), z gazy 17 nitkowej, 12 warst., o wym. 10cm/10cm ze znaczn. RTG,
- chusta laparotomijna 45x70 cm – 5 szt., z gazy 17 nitkowej, 4 warst., ze znaczn. RTG oraz tasiemką,
- skalpel chirurg. z nasadką zabezpieczającą, rozm. 11,
- kleszczyki blokowane 24 cm do mat. opatr., - pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Zapytanie 112 – dot. Istotnych Postanowień Umowy

„Jaką ilość (jaki procent) towarów określonych w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający zamówi na pewno?”

Odpowiedź:

Zamawiający jako rzetelny uczestnik obrotu oszacował z należytą starannością wielkość na podstawie dotychczasowego zużycia, gdzie ilości faktycznie zestawione są związane z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi.

Zapytanie 113 – dot. Istotnych Postanowień Umowy

„Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?”

Odpowiedź:

Niezmiennosc cen brutto.

Zapytanie 114 – dot. Istotnych Postanowień Umowy

„Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej z przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy i przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 115 – dot. § 8 ust. 1 Istotnych Postanowień Umowy

„Czy Zamawiający zgodzi się zastąpić słowa „opóźnienie” oraz „opóźnienia” słowami „zwłokę” oraz „zwłoki” w § 8 ust. 1 Istotnych Postanowień Umowy?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 116 – dot. Istotnych Postanowień Umowy

„Czy Zamawiający przed naliczeniem kary umownej, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 117 – dot. Pozycji nr 20 oraz 21

„Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ma na myśli włókninę polipropylenową. TMS jest nazwą używaną przez jedną z firm w celu określenia włókniny polipropylenowej.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 118 – dot. Istotnych Postanowień Umowy

„Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. Wyszczególnienie powyższego zapisu jest podyktowane prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%.

Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE (zgodnie z tą normą, nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili obecnej).

Zgodnie z powyższym, przy zasadach jakie stosuje się przygotowując wyceny do przetargu (gdzie marże ustala się na bardzo niskim poziomie) - podniesienie stawki VAT o 15% jest dla większości dystrybutorów niemożliwe do zaakceptowania.

Konieczność utrzymania ceny brutto na niezmiennym poziomie spowoduje, że realizacja części umowy będzie odbywała się ze stratą dla Wykonawcy.

Biorąc pod uwagę powyższe, żadna z firm nie może pozwolić sobie na złożenie oferty z góry zakładając stratę, dlatego też już obecnie przy kalkulacji cen do przetargu należy wziąć pod uwagę ewentualną podwyżkę stawki VAT.

Z kolei to rozwiązanie jest niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje to przekroczenie szacunków do przetargu a następnie zakup sprzętu medycznego w wyższych cenach od początku trwania umowy, a nie od ewentualnej podwyżki stawki VAT.”

Odpowiedź:

Niezmiennosc cen brutto.

~~lek. med. Włodzimierz Kłgacz
Szpital im. Stanisława Łaszczynskiego
w Katowicach~~