



# Katowickie Centrum Onkologii

UL. RACIBORSKA 26 40-074 KATOWICE

<http://www.kco.katowice.pl>

e-mail: [szpital@kco.katowice.pl](mailto:szpital@kco.katowice.pl)

Tel. 32 2511-761

Fax. 32 2514-533

K.C.O./AT/ZL/ZP/RII 2143/16

Katowice, dnia 05.12.2016 r.

## Zapytania do SIWZ

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczanie produktów i zestawów medycznych z włókniny i flizeliny jednorazowego i wielorazowego użytku  
**oznaczenie sprawy:** KCO/PN/79/2016

Zamawiający – Katowickie Centrum Onkologii informuje, że wpłynęły zapytania do sspecyfikacji istotnych warunków zamówienia:

### **Zapytanie nr 1 – dot. Pozycji nr 17**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach poz.17 czepka z włókniny o gramaturze min.12g/m<sup>2</sup>?”

**Odpowiedź:**

Nie.

### **Zapytanie nr 2 – dot. Pozycji nr 18**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach poz.18 czepka z chłonnej włókniny wiskozowej bez dodatkowego potnika, ale z możliwością wywinięcia części przedniej?”

**Odpowiedź:**

Nie.

### **Zapytanie nr 3 – dot. Pozycji nr 20**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach poz.20 prześcieradła z włókniny równoważnej SMS? Nazwa SMS dotyczy włókniny SMS stosowanej przez jedną z firm?”

**Odpowiedź:**

Tak.

### **Zapytanie nr 4 – dot. Pozycji nr 21**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach poz.21 pościeli z włókniny równoważnej SMS? Nazwa SMS dotyczy włókniny SMS stosowanej przez jedną z firm.”

**Odpowiedź:**

Tak.

### **Zapytanie nr 5 – dot. Pozycji nr 21**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach poz.21 pościeli z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>?”

**Odpowiedź:**

Tak.

### **Zapytanie nr 6 – dot. Pozycji nr 17**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepek o gramaturze 14 g/m<sup>2</sup>?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 7 – dot. Pozycji nr 21**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pościeli z włókniny typu spunbond, gramatura zgodnie z wymogami Zamawiającego?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 8 – dot. Pozycji nr 37**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 9 – dot. Pozycji nr 3**

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia uniwersalnego spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego, które zawiera dodatkowo 2 ręczniki chłonne o wym. 30 x 40cm?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 10 – dot. Pozycji nr 4**

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia uniwersalnego wykonanego z 3-warstwowego laminatu o gramaturze 74,5 g/m<sup>2</sup> o wytrzymałości na wypychanie na mokro 224 kPa, nieprzemakalności 150 cm H<sub>2</sub>O? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 11 – dot. Pozycji nr 4**

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia uniwersalnego wykonanego z chłonnego, nieprzemakalnego 3-warstwowego laminatu o gram. 109,5 g/m<sup>2</sup> wokół pola operacyjnego, o wytrzymałości na wypychanie na mokro 270 kPa, nieprzemakalności > 125 cm H<sub>2</sub>O, pozostały obszar obłożenia wykonany z materiału 2-warstwowego o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>, o wytrzymałości na wypychanie na mokro 274 kPa, nieprzemakalności 125 cm H<sub>2</sub>O? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 12 – dot. Pozycji nr 5**

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do cięcia cesarskiego zawierającego serwetę o rozmiarze 335 x 260/200 cm z otworem prostokątnym 27 x 33 cm z oknem otoczonym folią chirurgiczną 14 x 20 cm? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 13 – dot. Pozycji nr 6**

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do zabiegów ginekologicznych dolnych wykonanego z chłonnego, mocnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gram. 57,5 g/m<sup>2</sup>, wzmocnionego dodatkową trzecią warstwą laminatu wokół pola operacyjnego o łącznej gramaturze 109,5 g/m<sup>2</sup> spełniającego wymogi normy EN 13795 (1-3), składającego się z serwety o wym. 230 x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, posiadającej otwór na krocz 10 x 15cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem, 1 serwety na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, 2 ręczników 30 x 40 cm, 1 serwety na stolik Mayo 80 x 145 cm, taśmę lepnej 9 x 50cm i serwety samoprzylepnej 50 x 50cm?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 14 – dot. Pozycji nr 7**

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania obłożenia do laparoskopii ginekologicznej wykonanego z chlornego, mocnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>, posiadającego dodatkowo wzmocnienie w strefie krytycznej o 109,5 g/m<sup>2</sup> (gramatura podstawowa plus wzmocnienie). Obłożenie spełnia wymogi normy EN 13795 (1-3), posiada serwetę główną o wymiarach 260 cm x 310 cm, wyposażoną w zintegrowane osłony na kończyny dolne, organizatory przewodów, samoprzylepny otwór w okolicy jamy brzusznej o wymiarach 28 cm x 32 cm oraz samoprzylepny otwór w okolicach kroczka o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczony klapką. Zestaw posiada serwetę na stolik Mayo 80x145 cm, 4 ręczniki 30 x 40 cm oraz serwetę na stolik (owinięcie zestawu) o wymiarze 150 x 190 cm. Obłożenie pakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Opakowanie posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 15 – dot. Pozycji nr 9**

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwety wykonanej z dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 16 – dot. Pozycji nr 10**

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania pokrowca na stolik Mayo wykonanego z folii PE o grubości 35 µm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 17 – dot. Pozycji nr 11**

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania fartucha ochronnego z włókniny, z mankietem w rozmiarze uniwersalnym o gram. 21 g/m<sup>2</sup>?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 18 – dot. Pozycji nr 24**

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwety operacyjnej po wstępnym praniu o rozmiarze 50 x 60 cm? Pozostałe parametry serwety zgodne z wymaganiami Zamawiającego.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 19 – dot. Pozycji nr 29**

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwety sterylnych fartuchów o gram. 35 g/m<sup>2</sup>, wykonanych w części przedniej i na przedramionach z laminatu o gram. 28 g/m<sup>2</sup> ? Pozostałe parametry serwety zgodne z wymaganiami.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża na to zgody.

**Zapytanie nr 20 – dot. Pozycji nr 3**

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaferowania zestawu obłożenia uniwersalnego o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 150cm;
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240cm

- 2 serwety samoprzylepne 75 x 90cm;
- 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50
- 2 ręczniki 40 x 40

Obłożenie charakteryzują się wytrzymałością na rozrywanie na poziomie 80 Kpa?"

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża na to zgody.

**Zapytanie nr 21 – dot. Pozycji nr 4**

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania zestawu obłożenia uniwersalnego o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 150cm;
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240cm
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 90cm;
- 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50
- 2 ręczniki 40 x 40

Obłożenie charakteryzują się wytrzymałością na rozrywanie na poziomie 80 Kpa?"

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża na to zgody.

**Zapytanie nr 22 – dot. Pozycji nr 5**

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania zestawu obłożenia do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;
- 1 serweta dla noworodka 60 x 80 cm
- 4 ręczniki do rak
- 1 serweta główna 160x300 z otworem 30x25cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów , 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka
- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów ”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża na to zgodę.

**Zapytanie nr 23 – dot. Pozycji nr 11**

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania fartucha ochronnego w rozmiarze uniwersalnym?"

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 24 – dot. Pozycji nr 12 i 29**

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania fartucha ochronnego wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMMS?"

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża na to zgody.

**Zapytanie nr 25 – dot. Pozycji nr 20**

„Czy Zamawiający wymaga prześcieradła z włókniny polipropylenowej?"

**Odpowiedź:**

Dopuszcza, nie wymaga.

**Zapytanie nr 26 – dot. Pozycji nr 2-7, 9, 10, 12, 14, 22, 27-29, 33-35, 38, 42**

„Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu załączenia do oferty arkuszy danych technicznych materiału podstawowego włókniny, a zastąpienie go kartą techniczną wyrobów zgodnych z normą 13795 1-3?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 27 – dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zabezpieczenia należytego wykonania umowy dot. pozycji 3, 5, 12, 14, 40, 42, 43?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 28 – dot. §8 ust. 2 Istotnych postanowień umowy**

„Czy Zamawiający odstąpi od karania Wykonawcy karą 500 zł za brak wyładunku i wniesienia lub dopuści możliwość dostawy towarów poprzez firmę kurierską metodą burla-burla tj. kurier dostarcza towar do drzwi Zamawiającego? Taki zapis umowny faworyzuje firmy z rynku lokalnego, utrudnia uczciwą konkurencję i jest nie zgodny zasadą równego fraktowania.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 29 – dot. §9 ust. 3.1 i 3.2 Istotnych postanowień umowy**

„Czy Zamawiający zmniejszy karę umowną do 0,5% wartości niedostarczonego towaru brutto, aktualna wielkość kary 10% od wartości umowy jest niewspółmierna do ewentualnie wyrządzonej krzywdy? Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu z paragrafu 9 pkt. 3.2?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 30 – dot. Pozycji nr 1**

„Poz. 1: Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarach: L, XL, i XXI?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 31 – dot. Pozycji nr 1**

„Poz. 1: Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarach: M, L, XL i XXL?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 32 – dot. Pozycji nr 5**

„Poz. 5: Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany z włókniny laminowanej min. dwuwarstwowej o gramaturze min. 43 g/m<sup>2</sup>?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 33 – dot. Pozycji nr 5**

„Poz. 5: Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z otworem prostokątnym 32x35cm wypełnionym folią chirurgiczną i z workiem na płyny	1	300-320 x180
podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic	1	90x60
serweta na stół instrum. (owinięcie zestawu)	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk z włókniny kompresowej	2	40x20”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 34 – dot. Pozycji nr 7**

„Poz. 7: Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serweta z otworem 28x10x19cm w kształcie trapezu, przylepcem, zintegrowanymi nogawicami i klapą przesłaniającą	1	265x180
serweta	1	90x75
taśma medyczna	1	50x9
serweta na stół instrum.	1	190x150
serweta na stółik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk z włókniny kompresowej	2	40x20

oraz poza zestawem dołączona kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 2x21x35cm?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 35 – dot. Pozycji nr 8**

„Poz. 8: Czy Zamawiający dopuści pokrowiec foliowy w rozm. 13x244cm?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 36 – dot. Pozycji nr 8**

„Poz. 8: Czy Zamawiający dopuści pokrowiec foliowy z rozm. 15x250cm nie posiadający dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 37 – dot. Pozycji nr 9**

„Poz. 9: Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z laminatu o gramaturze min. 56g/m<sup>2</sup>?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 38 – dot. Pozycji nr 11**

„Poz. 11: Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny wykonany z włókniny o gramaturze min. 17g/m<sup>2</sup>, z mankietem zakończonym gumką, w rozmiarze uniwersalnym? Jak wynika z opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga fartucha ochronnego, a nie fartucha chirurgicznego. Także wymóg 35g/m<sup>2</sup> wydaje się być bezpodstawny.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 39 – dot. Pozycji nr 14**

„Poz. 14: Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z poliestru 99,3% + 0,7% włókno węglowe, o gramaturze min. 84g/m<sup>2</sup> na całej powierzchni?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 40 – dot. Pozycji nr 21**

„Poz. 21: Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o wymiarach: poszwa 200x150cm, powłoczka 90x75cm, prześcieradło 210x150cm?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 41 – dot. Pozycji nr 24-26**

„Poz. 24-26: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów sterylizowanych parą wodną, metodą najbezpieczniejszą dla pacjenta i personelu?”

**Odpowiedź:**

Dopuszcza, nie wymaga.

**Zapytanie nr 42 – dot. Pozycji nr 26**

„Poz. 26: Czy Zamawiający ma na myśli serwetę pakowaną po 1 szt.?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 43 – dot. Pozycji nr 27**

„Poz. 27: Czy Zamawiający dopuści serwetę bez przyłapca?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 44 – dot. Pozycji nr 35**

„Poz. 35: Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą z otworem prostokątnym w rozmiarze 35x32cm oraz z chustą laparatomijną z gazy 17 nitkowej?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 45 – dot. Pozycji nr 42**

„Poz. 42: Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą 150x200cm (zamiast 150x210cm)?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 46 – dot. §8 ust. 1 Istotnych postanowień umowy**

„Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwłoki” w §8 ust. 1”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 47 – dot. Istotnych postanowień umowy**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy była naliczana od części zamówienia nie zrealizowanego w terminie, a nie od wartości całej umowy?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 48 – dot. Istotnych postanowień umowy**

„Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany ceny brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 49 – dot. Pozycji nr 2**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 serwety o wymiarach 50x60cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 50 – dot. Pozycji nr 3**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 3 sterylne obłożenia uniwersalnego zgodnego z opisem zawartym w SIWZ, zawierającego w swoim składzie dodatkowo 2 ręczniki do rąk oraz 1 taśmę przyłepną 9x50cm?”

**Odpowiedź:**

Tak

#### Zapytanie nr 51 – dot. Pozycji nr 4

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 4 sterylnej obłożenia uniwersalnego zgodnego z opisem zawartym w SIWZ, o nieprzemakalności 167cm H<sub>2</sub>O, serwetka górna i dolna wykonana z laminatu trzywarstwowego w części dedykowanej dla pacjenta, serwetki boczne w całości wykonane z laminatu trzywarstwowego. Dodatkowo w serwetkach: dolnej i bocznych kuta chłonna o wymiarach 15x50cm”


#### Odpowiedź:

Nie

#### Zapytanie nr 52 – dot. Pozycji nr 5

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 5 zestawu w niżej opisanym składzie, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”

- 4 ręczniki do rąk
- 1 taśma przyklepna 9 x 50 cm
- 1 serwetka stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm, składana teleskopowo
- 1 serwetka dla dziecka 75 x 120 cm
- 1 serwetka do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm z torebką na płyny wyposażoną w sztywnek, bez zaworu drenażowego, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów
- 1 serwetka na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (owinięcie zestawu).”

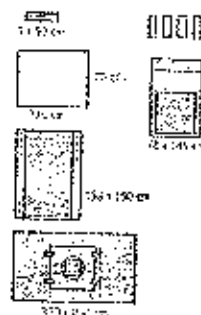

#### Odpowiedź:


Tak.

#### Zapytanie nr 53 – dot. Pozycji nr 6

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 6 niżej opisanego zestawu?”

Zestaw wykonany z chłonnego, mocnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, spełniający wymogi normy EN 13795 (1-3), w składzie:

- 1 serwetka stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm 2 ręczniki do rąk
- 2 taśmy przyklepne 9 x 50 cm
- 1 serwetka brzuszno-kroczoowa 220/240 x 335 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przyklepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonięcia otworu, kiedy nie jest używany)
- 1 serwetka na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

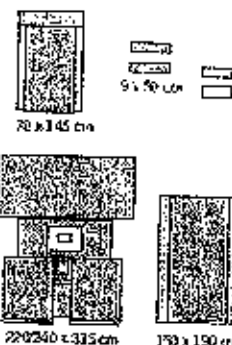

Zestaw pakowany zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Opakowanie zawiera 4 naklejki do umieszczania w dokumentacji medycznej z nr katalogowym, nr lot, datą ważności oraz nazwą identyfikującą producenta.”

#### Odpowiedź:


Tak

#### Zapytanie nr 54 – dot. Pozycji nr 7

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 6 niżej opisanego zestawu?”

Zestaw wykonany z chłonnego, mocnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, spełniający wymogi normy EN 13795 (1-3), w składzie:

- 1 serwetka stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm 2 ręczniki do rąk
- 2 taśmy przyklepne 9 x 50 cm
- 1 serwetka brzuszno-kroczoowa 220/240 x 335 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przyklepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonięcia otworu, kiedy nie jest używany)

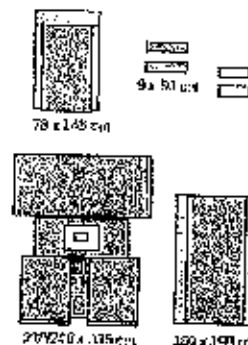



- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm
- ewentualnie kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 15x25cm x 30cm – pakowana osobno

Zestaw pakowany zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Opakowanie zawiera 4 naklejki do umieszczania w dokumentacji medycznej z nr katalogowym, nr lot, datą ważności oraz nazwą identyfikującą producenta.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 55 – dot. Pozycji nr 8**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej pokrowca na kofezyne posiadającego 1 taśmę odporną na przemakanie umieszczoną na końcu, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 56 – dot. Pozycji nr 9**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 9 sterylnej serwety spełniającej wymogi zawarte w SIWZ, z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 57 – dot. Pozycji nr 11**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 11 fartucha ochronnego z włókniny o gramaturze 25g/m<sup>2</sup> w rozmiarze uniwersalnym 120 x 145cm?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 58 – dot. Pozycji nr 17**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 17 niesterylnego czepka chirurgicznego o gramaturze 14g/m<sup>2</sup>, pakowanego w karton po 150szt, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 59 – dot. Pozycji nr 24 i 25**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 24 i 25 serwet operacyjnych z taśmą i elementem RTG, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”

Przytaczany "element RTG" to nic innego, jak taśma poliestrowa wszyta w brzeg serwety, kontrastująca w promieniach RTG, koloru niebieskiego - zastępuje ona nitkę RTG, a jej zastosowanie jest coraz powszechniej stosowane na blokach operacyjnych.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 60 – dot. Pozycji nr 27 i 28**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 27 i 28 serwety z otworem o średnicy 6x8cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 61 – dot. Pozycji nr 33**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 33 zestawu w niżej opisanym składzie:

- serweta włókninowa barierowa 2 warstwowa 75 x 90cm – 1szt
- opatrunek foliowy poliuretanowy zabezp. wkłucie 10 x 12cm - 1szt
- taca medyczna 11x13x5cm - 1szt



- kompresy gazowe 17-nitkowe, 8 warstwowe 5x5cm - 2szt
- kompresy gazowe 17-nitkowe, 8 warstwowe 7,5x7,5cm - 6szt
- tufery gazowe 30 x 30cm - 5szt
- pęseta anatomiczna j.u. - 1szt
- nożyczki metalowe j.u. do nici - 1szt
- igłotrzymacz metalowy czarny - 1szt
- kleszczyki niebieskie 13 cm - 1szt
- skalpel jednorazowego użytku 11cm - 1szt
- strzykawka jednorazowa 10ml - 1szt
- strzykawka jednorazowa 20ml - 1szt
- igła iniekcyjna czarna - 1szt
- igła iniekcyjna różowa - 1 szt

Opakowanie zawiera informację o dacie ważności i nr serii w formie 2 naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej."

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 62 – dot. Pozycji nr 36**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 36 kieszeni dwukomorowej o wymiarach 30x40cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 63 – dot. Pozycji nr 39**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 39 sterylnego zestawu do usuwania szwów w składzie:

rękawice zabiegowe lateksowe bezpydrowe M – 2 szt.

pęseta metalowa 12,5cm – 1szt

nożyczki metalowe ostre, zagięte 11cm – 1szt

tufery 20x19cm – 6 szt.

Całość twardej opakowaniu. Opakowanie zawiera informację o dacie ważności i nr serii w formie 2 naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej."

**Odpowiedź:**

Jeżeli dot. Pozycji nr 40 – Tak.

**Zapytanie nr 64 – dot. Pozycji nr 2**

„Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 2 zaoferowano sterylną serwetę w rozmiarze 75x45 cm, której opakowanie nie posiada naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 65 – dot. Pozycji nr 3**

„Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 3 zaoferowano sterylne obłożenie uniwersalne wykonane z laminatu trójwarstwowego, które dodatkowo w swoim składzie zawiera taśmę samoprzylepną i ręczniki chłonne a wytrzymałość obłożenia na rozzerwanie wynosi 50 kpa. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 66 – dot. Pozycji nr 4**

„Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 4 zaoferowano sterylne obłożenie uniwersalne wykonane z laminatu trójwarstwowego, którego wytrzymałość na rozzerwanie wynosi 50 kpa? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 67 – dot. Pozycji nr 5**

„Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 5 zaofertowano sterylny zestaw do cięcia cesarskiego wykonany z laminatu dwuwarstwowego o składzie:

- serweta chirurgiczna do cięcia cesarskiego o wymiarach 180x300 cm posiadająca otwór w kształcie trapezu o wymiarach: wysokość 23 cm, dolna podstawa 33 cm, górna podstawa 23 cm, wypełniony folią chirurgiczną, posiadająca zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów wyposażony w sztywnik i zawór drenażowy
- serweta - owinięcie noworodka 80x90 cm
- taśmy samoprzylepne 9x49 cm
- ręczniki chłonne 30x40 cm- 4szt
- osłona na stolik MAYO 79x145 cm
- serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150x200 cm

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 68 – dot. Pozycji nr 6**

„Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 6 zaofertowano sterylny zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych bez serwety na stolik Mayo? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 69 – dot. Pozycji nr 7**

„Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 7 zaofertowano sterylny zestaw do laparoskopii ginekologicznej wykonany z laminatu dwuwarstwowego, w którym serweta główna o wymiarach: 180/270x220 cm jest zintegrowana z nogawicami, posiada otwór w kształcie trapezu w okolicach jamy brzusznej o wymiarach: 20x30x20 cm oraz otwór w okolicach kroczu z zabezpieczeniem w postaci osłony o wymiarach 10x15 cm. Natomiast kieszeń dwukomorowa, samoprzylepna wyposażona w sztywnik o wymiarach 2x15x40 nie jest zintegrowana z obłożeniem? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 70 – dot. Pozycji nr 8**

„Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 8 zaofertowano sterylny pokrowiec foliowy na przewody o wymiarach 17x200 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 71 – dot. Pozycji nr 12**

„Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 12 zaofertowano sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>? Dostępne rozmiary L,XL,XLL przy czym rozmiar XLL jest szwedzkim odpowiednikiem i odpowiada rozmiarowi XXI? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 72 – dot. Pozycji nr 13**

„Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 13 zaofertowano niesterylny fartuch przedni wykonany z włókniny foliowanej w następujących rozmiarach: 75x155 cm oraz 75x115 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Nie.

*Handwritten signature and initials.*

**Zapytanie nr 73 – dot. Pozycji nr 24**

„Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 24 zaoferowano sterylną serwetę operacyjną o wymiarach 40x60 cm, pakowaną po 2 sztuki, wykonaną z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 155 g/m<sup>2</sup>? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 74 – dot. Pozycji nr 25**

„Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 25 zaoferowano sterylną serwetę operacyjną o wymiarach 40x40 cm, pakowaną po 5 sztuk, wykonaną z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 155 g/m<sup>2</sup>? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 75 – dot. Pozycji nr 29**

„Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 29 zaoferowano sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, natomiast przedramiona o gramaturze 40g/m<sup>2</sup> i część przednia o gramaturze 33g/m<sup>2</sup>? Dostępne rozmiary L,LL,XI, przy czym rozmiar L jest szwedzkim odpowiednikiem i odpowiada rozmiarowi M natomiast rozmiar LL odpowiada rozmiarowi L? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 76 – dot. Pozycji nr 36**

„Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 36 zaoferowano sterylną kieszeń dwukomorową samoprzylepną w rozmiarze 40x35 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Tak

**Zapytanie nr 77 – dot. Pozycji nr 3, 5, 9**

„Poz. nr 3; 5; 9- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet i zestawów wykonanych z 2-warstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 78 – dot. Pozycji nr 3**

„Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego posiadającego w swoim składzie serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 140 x 190 cm? Pozostałe parametry bez zmian”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 79 – dot. Pozycji nr 4**

„Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gram. min. 55 g/m<sup>2</sup> z dodatkowymi padami chłonnymi, posiadającego w swoim składzie serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 140 x 190 cm? Pozostałe parametry bez zmian”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 80 – dot. Pozycji nr 5**

„Poz. nr 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego posiadającego w swoim składzie serwetę główną z otworem w rozmiarze 19 x 29 cm, pakowanego w opakowanie posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci 4 naklejek? Pozostałe parametry bez zmian.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 81 – dot. Pozycji nr 12, 29**

„Poz. nr 12; 29- czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania fartuchów zapinanych przy szyi na taśmę samoprzylepną wielokrotnego użytku, która pozwala na precyzyjne dopasowanie fartucha do rozmiaru ciała operatora w dowolnym miejscu na wysokości barków? Pozostałe parametry bez zmian.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 82 – dot. Pozycji nr 17**

„Poz. nr 17- czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania czepka chirurgicznego o gramaturze 14 g/m<sup>2</sup>? Pozostałe parametry bez zmian”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 83 – dot. Pozycji nr 18**

„Poz. nr 18- czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania czepka chirurgicznego posiadającego wydłużoną część tylną ze ściągaczem, wykonanego na całej powierzchni z włókna pochłaniającej pot? Pozostałe parametry bez zmian.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 84 – dot. Pozycji nr 24, 25**

„Poz. nr 24- 25- czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania serwet operacyjnych pakowanych w opakowanie zawierające jedną naklejkę do umieszczenia w dokumentacji medycznej? Pozostałe parametry bez zmian.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 85 – dot. Pozycji nr 27**

„Poz. nr 27- czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania serwety wykonanej z laminatu 2-warstwowego ( polipropylen- polietylen)? Pozostałe parametry bez zmian.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 86 – dot. Pozycji nr 29**

„Poz. nr 29- czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania fartucha chirurgicznego, posiadającego wstawki w części przedniej i przedramionach wykonane z laminatu o gramaturze min. 38 g/m<sup>2</sup>?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 87 – dot. Pozycji nr 33-34**

„Poz. nr 33-34- zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu spełniania przez w/w zestawy wymagań normy PN-EN 13795 1-3 z jednoczesnym dopuszczeniem możliwości zaofiarowania zestawów ambulatoryjnych, w których składzie znajdują się serwety spełniające w/w normę”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 88 – dot. Pozycji nr 32**

„Poz. nr 32- czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania zestawu do cewnikowania pakowanego w opakowanie handlowe a’ 33 szt. o następującym składzie: ”

**Skład zestawu: \***

1. 6 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm
2. 4 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki (Fogasting Nr 3)
3. 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm
4. 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm
5. 1 x serweta włókninowa, nieprzyłepna 45 cm x 75 cm
6. 1 x serweta włókninowa, 45 cm x 75 cm z regulacją olewną (serweta składa się z 2 oddzielnych części), owwór przyklepny
7. 1 x strzykawka Luer 10 ml, (zapakowana)
8. 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18G x 1<sup>1/2</sup>, różowa (zapakowana)
9. 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21G x 1<sup>1/4</sup>, zielona (zapakowana)
10. 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane)
11. 1 x igłotrzymacz typu Delf 13 cm
12. 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej Hydrofilm 10 cm x 15 cm, (zapakowany)

**Opakowanie**

Tacka typu blister z 2 wgłębieniami na płynie, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

\* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

**Odpowiedź:**

Jeżeli dotyczy Pozycji nr 33 - Tak.

**Zapytanie nr 89 – dot. Pozycji nr 34**

„Poz. nr 34- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do znieczuleń, pakowanego w opakowanie handlowe a’ 24 szt. o następującym składzie:

- 1 x serweta włókninowa 75 cm x 90 cm
- 1 x serweta włókninowa 75 cm x 90 cm, z otworem i przyklepną krawędzią boczną
- 1 x kleszczyki typu Kocher, 14 cm
- 1 x strzykawka typu Luer Lock 5 ml
- 1 x igła 18G x 1 1/2
- 1 x igła 22G x 1 1/4
- 6 x tupfer z gazy wielkości śliwki
- 1 x opatrunek pooperacyjny 7,2 x 5 cm

Opakowanie: Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płynie, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 90 – dot. Pozycji nr 39**

„Poz. nr 39- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego, pakowanego w opakowanie handlowe a’ 72 szt. o następującym składzie:”

**Skład zestawu: \***

1. 6 x tampony włókninowe (tupfer) w kształcie kuli wielkości jajka
2. 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm

**Opakowanie**

Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płynie, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 91 – dot. Pozycji nr 40**

„Poz. nr 40- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do usuwania szwów pakowanego w opakowanie handlowe a’ 108 szt. o następującym składzie:”

Skład zestawu: \*

1. 3x tampony (tępe) wielkości sławki
2. 1x pęseta anatomiczna metalowa typu Adson 12 cm
3. 1x pęseta anatomiczna plastikowa 12,5 cm
4. 1x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane)

**Opakowanie**

Taceta typu blister z 1 wgłębieniem na płyty, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 92 – dot. Pozycji nr 41**

„**Poz. nr 41-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaopieczowania zestawu do usuwania zszywek o następującym składzie:

- 1 x kleszczyki jednorazowe do usuwania zszywek staplera
  - 4 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 8 warstw 17 nitek
  - 2 x rękawica nitrylowa bezpudrowa M
- Opakowanie papierowo- foliowe, miękkie.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 93 – dot. §3 ust. C Istotnych postanowień umowy**

„§ 3, ust. C- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących niezmienności cen na następującą:

„ Wykonawca gwarantuje przez cały okres obowiązywania umowy niezmiennosc cen brutto, z wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT, gdzie zmianie ulegnie cena brutto i podatek, cena netto pozostanie bez zmian”.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 94 – dot. §8 ust. 2 Istotnych postanowień umowy**

„§ 8, ust. 2- wnosimy o odstąpienie od zapisów wymienionego paragrafu. Zamawiający w § 2, ust. 3 jasno określił, iż towar ma zostać dostarczony „ loco” ( bezpośrednio ) magazyn szpitala. Wobec tego naliczanie kar umownych w tym przypadku wydaje się bezpodstawne.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 95 – dot. Pozycji nr 14**

„Zamawiający w pozycji nr 14 złożył zamówienie na fartuch chirurgiczny barierowy wielokrotnego użytku, zgodny z normą PN-EN 13795, wykonany z poliestru 98-99% +1-2% włókno węglowe (antyelektrostatyczne), gramatura pola krytycznego ok. 122-135g/m2, - gramatura pola niekrytycznego ok. 74-125 g/m2, z tkaniny oddychającej.

Fartuch skonstruowany w ten sposób jest niekomfortowy. Najlepszym rozwiązaniem dla fartuchów operacyjnych wielorazowych jest stosowanie tkanin poliestrowych w polu krytycznym oraz tkanin bawełniano – poliestrowych w polu niekrytycznym. Tylko taka konstrukcja zapewnia maksimum bezpieczeństwa i komfortu. W ofercie posiadamy fartuchy operacyjne wykonane:

- w polu krytycznym z tkaniny poliestrowej 99% poliestru 1% włókna węglowego o gramaturze 100 g/m2 o odporności na przenikanie cieczy powyżej 90 cm H2O, w pełni zgodnej z normą PN-EN 13795,
- w polu niekrytycznym natomiast z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano – poliestrowej 60% bawełny, 40% poliestru o gramaturze 125 g/m2.

Taka konstrukcja fartuchów operacyjnych jest najbardziej komfortowa, ale też bezpieczna z punktu widzenia operatorów. Wysoka odporność pola krytycznego na przenikanie cieczy na poziomie powyżej 90 cm H2O zapewnia duży poziom bezpieczeństwa. Natomiast doskonałe właściwości „oddychania” w polu niekrytycznym sprawiają, że komfort pracy jest bardzo duży.

Czy Zamawiający, dbając o bezpieczeństwo i komfort użytkownika wymaga w Pozycji 14 fartuchów operacyjnych o konstrukcji jak poniżej:

- strefa krytyczna z tkaniny poliestrowej o gramaturze max. 100 g/m<sup>2</sup> o odporności na przeciekanie cieczy co najmniej 90 cm H<sub>2</sub>O,

- strefa niekrytyczna z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano – poliestrowej o zawartości bawełny min. 60%, o gramaturze 125 g/m<sup>2</sup>?

Fartuchy w pełni zgodne z normą PN-EN 13795.

Taka konstrukcja fartucha zapewnia bardzo duży poziom bezpieczeństwa oraz maksymalnie możliwy komfort pracy. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Dopuszcza, nie wymaga.

**Zapytanie nr 96 – dot. Pozycji nr 14**

„Czy Zamawiający wymaga aby fartuchy operacyjne z pozycji 14 były bezwzględnie zgodne z normą PN-EN 13795 w zakresie wszystkich opisanych w Normie parametrów?

Fartuchy o niepełnej zgodności nie zapewniają maksymalnego bezpieczeństwa podczas zabiegów.”

**Odpowiedź:**

Tak, wymaga.

**Zapytanie nr 97 – dot. Pozycji nr 1**

„Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny tylko w rozmiarach L, XL i XXI?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 98 – dot. Pozycji nr 1**

„Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o długości dla L-120cm, XL-125cm, XXL-130cm?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 99 – dot. Pozycji nr 2**

„Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 70x50cm?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 100 – dot. Pozycji nr 2**

„Czy Zamawiający dopuści serwetę w opakowaniu z 4 naklejkami do umieszczenia w dokumentacji medycznej?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 101 – dot. Pozycji nr 3**

„Czy Zamawiający dopuści obłożenie uniwersalne o składzie i parametrach zgodnych z SIWZ dodatkowo z 2 szt ręczników chłonnych i z jedną taśmą samoprzylepną?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 102 – dot. Pozycji nr 3-10, 12, 27, 28, 29, 36**

„Czy Zamawiający dopuści opakowanie posiadające 4 naklejki typu TAG służące do wklejania do dokumentacji pacjenta?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 103 – dot. Pozycji nr 4**

„Czy Zamawiający dopuści obłożenie wykonane z 2 warstwowego chłonnego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 57g/m<sup>2</sup>, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?”



**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 104 – dot. Pozycji nr 5**

„Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm z portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup>
---

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m <sup>2</sup>
---

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m <sup>2</sup>
--

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup>
--

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m <sup>2</sup> . Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
---

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m <sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m <sup>2</sup> . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m <sup>2</sup> .”
---

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 105 – dot. Pozycji nr 6**

„Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów ginekologicznych o składzie:

1 x serweta 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy kroczu o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup> , w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> , zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 50 x 50 wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu
---

1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m <sup>2</sup>
--

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m <sup>2</sup>
---

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m <sup>2</sup>
---

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m <sup>2</sup> . Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
---

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m <sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m <sup>2</sup> . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m <sup>2</sup> .”
---

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 106 – dot. Pozycji nr 7**

„Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii o składzie:

1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup> , w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> , zintegrowana z organizatorami przewodów.
---

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m <sup>2</sup>
--

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m <sup>2</sup>
---

1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
--

*Handwritten signature and initials:*  
 L... M... S... (C...)

1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przyklepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup> .
1 x samoprzylepna kieszka jednokomorowa o wymiarach 30 cm x 40 cm ze sztywnikiem, wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 65 g/m <sup>2</sup>
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m <sup>2</sup> . Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m <sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m <sup>2</sup> . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m <sup>2</sup> ."

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 107 – dot. Pozycji nr 7**

„Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii o składzie:

1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m <sup>2</sup> , w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> , zintegrowana z organizatorami przewodów.
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m <sup>2</sup>
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m <sup>2</sup>
1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przyklepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup> .
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m <sup>2</sup> . Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m <sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m <sup>2</sup> . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m <sup>2</sup> ."

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 108 – dot. Pozycji nr 9**

„Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z 2 warstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 109 – dot. Pozycji nr 9**

„Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z 3 warstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 75g/m<sup>2</sup>?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 110 – dot. Pozycji nr 9**

„Czy Zamawiający dopuści serwetę o wytrzymałości na rozrywanie 108 Kpa?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 111 – dot. Pozycji nr 10**

„Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo wzmocnioną, czerwona. Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety. Warstwa włókniny pochłania wilgoć, plynny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 80g/m<sup>2</sup>. Boki i część dolna serwety jednowarstwowe z PE o gramaturze 50g/m<sup>2</sup>. Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmocniającej 140 cm x 60 cm. Chłonność serwety 350%.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 112 – dot. Pozycji nr 11**

„Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny tylko w rozmiarze L i XL?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 113 – dot. Pozycji nr 18**

„Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany w całości z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m<sup>2</sup> z wstawką przeciwpotną?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 114 – dot. Pozycji nr 18**

„Czy Zamawiający dopuści czepek o właściwościach:

- Czepek głęboki typu „furażerka” z trokanii
- Wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>
- Zapewnia doskonałą oddychalność i komfort użytkowania
- Po wywinięciu część przednia utworzy dodatkową warstwę stanowiącą zabezpieczenie przed potem
- Kolor: zielony, niebieski
- Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający pojedyncze wyjmowanie
- Niejałowy”



**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 115 – dot. Pozycji nr 21**

„Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m<sup>2</sup> z prześcieradłem o wymiarach 210x150cm, pozostałe składowe zgodne z SIWZ?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 116 – dot. Pozycji nr 22, 24-26, 31**

„Czy Zamawiający odstąpi od wymogu opakowania zawierającego naklejki do umieszczenia w dokumentacji, informacje o dacie ważności i serii zawiera etykieta opakowania?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 117 – dot. Pozycji nr 26**

„Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a’2sz4 z przeliczeniem podanych ilości?”

**Odpowiedź:**

Nie.

*Handwritten signature and initials.*

**Zapytanie nr 118 – dot. Pozycji nr 29**

„Czy Zamawiający dopuści fartuch ze wzmocnieniem w części przedniej i przedramion z laminatu o gramaturze 38g/m<sup>2</sup>, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 119 – dot. Pozycji nr 30**

„Czy Zamawiający dopuści czeppek o wyglądzie i właściwościach:

- Czeppek z wstawką antypotną w części czołowej
- Z wydłużoną częścią tylną z gumką
- Dzięki specjalnej konstrukcji świetnie podtrzymuje włosy oraz dopasowuje się do kształtu głowy
- Stanowi doskonałe zabezpieczenie dla osób z dłuższymi włosami
- Wykonany z włókniny Spunlace oraz włókniny polipropylenowej
- Doskonała oddychalność i komfort użytkowania
- Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający pojedyncze wyjmowanie pojedynczych sztuk
- Jednorazowego użytku, Niejałowy”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 120 – dot. Pozycji nr 32**

„Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną 3 warstwową?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 121 – dot. Pozycji nr 36**

„Czy Zamawiający dopuści kieszon w rozmiarze 30x40cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 122 – dot. Pozycji nr 38-40, 42**

„Czy Zamawiający dopuści zestawy w opakowaniu folia-papier?”

**Odpowiedź:**

Pozycja nr 38-40 – Nie.

Pozycja nr 42 – Tak.

**Zapytanie nr 123 – dot. Pozycji nr 33**

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- Serweta operacyjna 50cm x 70cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową 1 szt.
- Serweta operacyjna jałowa 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem 6 x 8 cm 1 szt.
- Kompres gaz.niejał.17N 8W 7,5cmx7,5cm 10 szt.
- Tupfory gazowe kule 20cmx20cm niejałowe 10 szt.
- Pęseta sterylna j.u. plastikowa dł. 13 cm 1 szt.
- Łłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy j.u. 15cm 1 szt.
- Strzykawka j.u. 3-częściowa 20 ml Luer 1 szt.
- Strzykawka j.u. 3-częściowa 10 ml Luer 1 szt.
- Igła iniekcyjna j.u. (0,8 x 40) dispoFINE 1 szt.
- Igła iniekcyjna j.u. (1,2 x 40) dispoFINE 1 szt.
- Ostrza chirurgiczne nr 11 1 szt.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 124 – dot. Pozycji nr 34**

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- Prześcieradło jednorazowego użytku 80 x 90 (niebieski SMS) 1 szt.
- Serweta operacyjna jałowa 50cm x 70cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową 1 szt.
- Serweta operacyjna jałowa 50 x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 7cm 1szt.
- Kompres gaz.niejał.17N 8W 10cmx10cm 10 szt.
- Pęseta sterylna j.u. plastikowa dł. 13 cm 1 szt.
- Strzykawką j.u. 3-częściowa 5 ml Luer 2 szt.
- Igła iniekcyjna j.u. (1,2 x 40) dispoFINE 1 szt.
- Igła iniekcyjna j.u. (0,6 x 40) dispoFINE 1 szt.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SJWZ.

**Zapytanie nr 125 – dot. Pozycji nr 38**

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

L.p.	Zawartość Pakietu	Ilość
1	Serweta operacyjna 50cm x 50cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową	1
2	Serweta operacyjna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7 cm	1
3	Rękawice lateks bezpydrowe rozm.M diagnostyczne	2
4	Tupfery gazowe 15cmx15cm (kula okrągła)	5
5	Pęseta plastikowa j.u. niebieska, dł. 13 cm	1
6	Miseczka 120 ml okrągła śr.85mm x wys.30mm	1
7	Strzykawką j.u. trzyczęściowa 10 ml Luer	1
8	Igła iniekcyjna j.u. (0,8 x 40)	1
<b>PAKOWANE OSOBNO</b>		
9	Worek do zbiórki moczu 2l z odpływem typu T sterylny dł. 150cm	1
10	Cewnik Foley dwudrożny CH 16 bal.30-50ml z plastikową zastawką	1”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 126 – dot. Pozycji nr 39**

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

L.p.	Zawartość Pakietu	Ilość
1	Pęseta j.u. plastikowa	1 szt.
2	Tupfery gazowe kule 20cmx20cm	4 szt.
3	Serweta włókninowa 75 x 75 cm	1 szt.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 127 – dot. Pozycji nr 40**

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

L.p.	Zawartość Pakietu	Ilość
1	Tupfery gazowe kula 17N 20cmx20cm	6 szt.
2	Pęseta plastikowa j.u.	1 szt.

3	Ostrze chirurgiczne typu Stich Cutter, długie	1 szt.
4	Rękawice lateksowe, bezpudrowe rozm. M	2 szt."

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 128 – dot. Pozycji nr 42**

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

L.p.	Zawartość Pakietu	Ilość
1	Serweta operacyjna , 75cm x 75cm 2 warstwowa	1
2	Serweta operacyjna , 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 7 cm	1
3	Kompres gaz. 13N 8W 7,5cmx7,5cm	10
4	Opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, samoprzylepny 5cm x 7,2cm	1
5	Chwytnak plastikowy do tamponów j.u. dł.13,9cm	1
6	Ostrza chirurgiczne z trzonkiem 11	1
7	Igłotrysmacz metalowy MAYO HEGAR 15cm	1"

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 129 – dot. Pozycji nr 16**

„Pozycja 16 – Czy Zamawiający oczekuje maski chirurgicznej o wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej na poziomie 99,99%?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 130 – dot. Pozycji nr 32**

„Pozycja 32 – Czy Zamawiający oczekuje maski chirurgicznej o wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej na poziomie 99,99%?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 131 – dot. Pozycji nr 3**

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 3 sterylne obłożenia uniwersalnego z serwetą w rozmiarze 140x190cm, która służy jako pokrycie stolika instrumentalnego, reszta parametrów zgodna z wymaganiami Zamawiającego.”


**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 132 – dot. Pozycji nr 5**

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 5 zestaw sterylny do cięcia cesarskiego w następującym składzie:

- 1 czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm, o grubości 0,060 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m<sup>2</sup>.
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm,
- 1 serweta w kształcie T o wym. 200/250x315cm z przylepnym oknem całkowicie wypełnionym folią chirurgiczną o wym. 18x28x32cm otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm, 2. zaworami i kształtownikiem,
- 1 serweta do owinięcia noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m<sup>2</sup>o wym. 90x100cm
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm.”

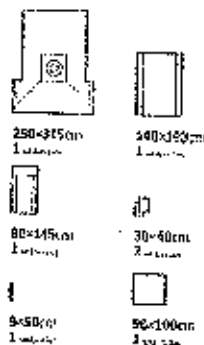

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża na to zgodę.

**Zapytanie nr 133 – dot. Pozycji nr 11**

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 11 fartuch ochronny w rozmiarach: M, L, XL, XXL o gramaturze min. 24 g/m<sup>2</sup>.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 134 – dot. Pozycji nr 19**

„Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji ochraniacze na obuwie o gramaturze min. 25g/m<sup>2</sup>, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 135 – dot. Pozycji nr 20**

„Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji serwetę z włókniny polipropylenowej trójwarstwowej SMS, o gramaturze min. 30g/m<sup>2</sup>, w rozmiarze 200x150cm? Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystniejszej cenowo oferty.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 136 – dot. Istotnych postanowień umowy**

„W związku z postępowaniem przetargowym ogłoszonym przez Państwa jednostkę oraz brakiem zamieszczenia w projekcie umowy stanowiącym załącznik NR 4 do SIWZ postanowienia, przewidującego zmianę (wzrost) ceny w przypadku zmiany (wzrostu) wysokości stawek podatku VAT, wnosimy o uzupełnienie treści projektu umowy o wskazany poniżej zapis umowy:

**Zamawiający zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy cenę netto powiększoną o należny podatek VAT w kwocie obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wystawienia faktury VAT.**

Stanowisko to motywowane jest następującymi względami:

Podatek VAT stanowi element cenotwórczy niezależny od woli Wykonawcy. Wliczona do ceny oferty kwota podatku VAT jako daniny publicznoprawnej, do odprowadzenia której zobowiązany jest Wykonawca, nie ma przy tym wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez Wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

W ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny brutto wyliczonej zgodnie ze stawkami podatku VAT obowiązującymi w dacie sporządzania oferty. Obliczenie ceny w oparciu o nieprawidłową (w tym także przyszłą, przewidywaną, lecz jeszcze nie obowiązującą) stawkę podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny skutkujący odrzuceniem oferty na zasadzie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

Wzrost stawek podatku VAT jest okolicznością zewnętrzną, na którą Wykonawcy nie mają żadnego wpływu. Wzrost taki, do którego dojść może w okresie trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego (przewidywana zmiana stawek podatku VAT na wyroby medyczne z 8 do 23%), przy obowiązku zachowania niezmiennej ceny brutto, spowoduje nie tylko zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia ceny oferty, lecz nawet

*Handwritten signature and stamp*

skutkować może rażąco strata po stronie Wykonawcy. Cenę ofertową Wykonawcy kalkulują bowiem według aktualnej stawki podatku VAT oraz – z uwagi na dużą konkurencję – przy przyjęciu minimalnej marży. W tym warunkach zwiększenie stawki podatku VAT o 15% powoduje, iż pierwotna kalkulacja ceny traci na aktualności, zaś umowa w sprawie zamówienia publicznego przynosi Wykonawcy straty.

W piśmiennictwie nie budzi wątpliwości dopuszczalność zawarcia w umowach dotyczących zamówień publicznych indeksacji wynagrodzenia bądź ceny stosownie do spodziewanej okoliczności w trakcie realizacji umowy (np. zmiany stawki podatku VAT). Chodzi tu bowiem o samoczynną korektę wynagrodzenia, na podstawie pierwotnej woli stron wyrażonej w umowie, a nie o nowelizację umowy co do zasady niedopuszczalną na mocy art. 144 p.z.p.

W związku z powyższym prawnie możliwym, a nade wszystko uzasadnionym jest, aby w ramach zasad obowiązujących w uczciwym obrocie handlowym, wprowadzili Państwo do projektu umowy stosowną klauzulę przewidującą zmianę ceny w związku ze zmianą stawki podatku VAT."

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

D Y R E K T O R  
Katowickiego Centrum Onkologii

lek. med. Włodzimierz Migacz

Handwritten signature and initials: "L. Migacz" and "SM" with a circled mark.